MiroCam® Guía rápida para el procedimiento con MiroView™ RTV

IntroMedic Capsule Endoscope

Cómo usar MiroView™ RTV con una computadora portátil

1 Antes de usar MiroView™ RTV

- El software MiroView™ RTV debe estar instalado previamente en la computadora portátil.

PRECAUCIÓN **Recargue la batería de la computadora solamente cuando el receptor MiroCam® esté desconectado.**

PRECAUCIÓN **Por favor, remítase al manual de instrucciones de la computadora para un uso seguro de ésta.**

PRECAUCIÓN **El software MiroView™ RTV no es una herramienta de diagnóstico. Use MiroView™ para ver imágenes del paciente en tiempo real y confirmar el paso de la cápsula por el duodeno.**

PRECAUCIÓN **No desconecte el receptor durante el funcionamiento de MiroView™ RTV o deberá reiniciar el software**.

2 Cómo hacer el estudio por cápsula

- Realización del estudio por cápsula.

PRECAUCIÓN **Para más información sobre el procedimiento de cápsula endoscópica MiroCam®, por favor vea la Guía rápida para procedimiento de cápsula endoscópica.**

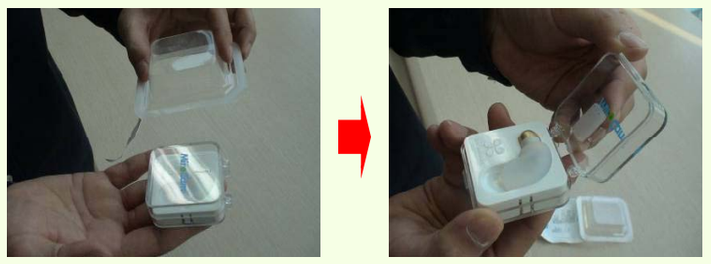

3 Conecte el lado pequeño del cable USB

- Conecte el lado pequeño del cable USB a la ranura del receptor MiroCam®.

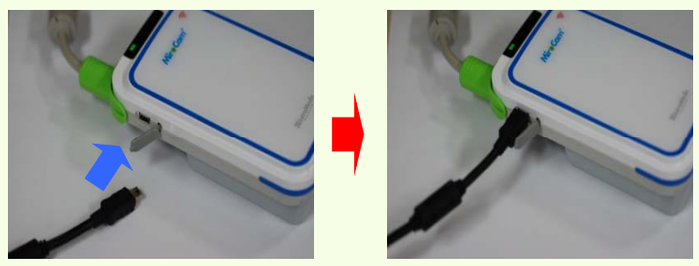

4 Conecte el lado grande del cable USB

- Conecte el lado grande del cable USB a la computadora.

5 Descripción de los botones

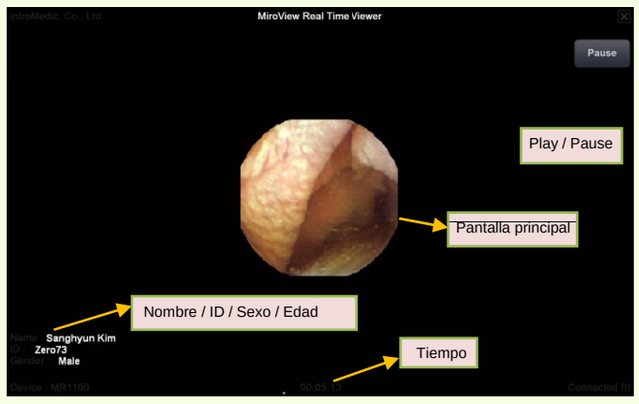

- Encienda la computadora portátil.
- Haga clic en para iniciar MiroView™ RTV.
- Haga clic en Play para empezar a mostrar imágenes.
- Haga clic en Pause para dejar de mostrar imágenes.
- Haga clic en (arriba a la derecha) para cerrar el programa.

Cómo usar Wireless MiroView™ RTVi con iPhone (iPad, iPod Touch)

1 Antes de usar Wireless MiroView™ RTVi

- El software Wireless MiroView™ RTVi debe estar previamente instalado en el i-Phone (iPad, iPod Touch)

PRECAUCIÓN **El usuario puede descargar e instalar la aplicación Wireless MiroView™ RTVi en el iPhone (iPad, iPod Touch) desde iTunes o App Store.**

PRECAUCIÓN **El software MiroView™ RTV no es una herramienta de diagnóstico. Use MiroView™ para ver imágenes del paciente en tiempo real y confirmar el paso de la cápsula por el duodeno.**

PRECAUCIÓN **No desconecte el receptor durante el funcionamiento de MiroView™ RTV o deberá reiniciar el software**.

.

2 Cómo hacer el estudio por cápsula

- Realización del estudio por cápsula.

PRECAUCIÓN **Para más información sobre el procedimiento de cápsula endoscópica MiroCam®, por favor vea la Guía rápida para procedimiento de cápsula endoscópica.**

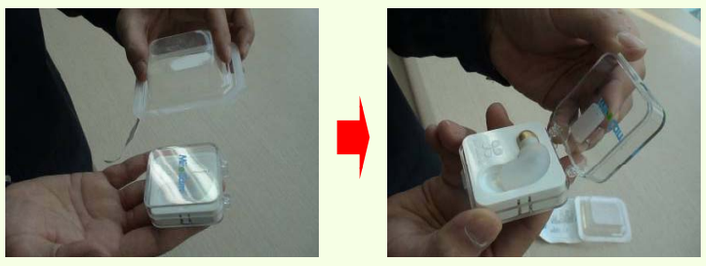

3 Activar el Wi-Fi

- Pulse el botón de Wi-Fi del receptor MiroCam®. Manténgalo pulsado hasta que suene el pitido.
- Vaya a la configuración del I-OS en el i-Phone.
- Active el Wi-Fi del i-Phone. Si éste ya esta activado, por favor desactívelo y vuélvalo a activar.

PRECAUCIÓN **El botón de Wi-Fi del receptor MiroCam® puede activarse de forma involuntaria. Asegúrese de que no está activado.**

4 Configuración TCP/IP

- Busque la red con SSID MiroCam_xxx en la lista de redes.
- Haga clic en al lado de ése SSID (MiroCam_xxx).
- Haga clic en el botón “Estática”.
- Configure la red como estática. Dirección IP: 192.168.3.200; máscara de subred: 255.255.255.0). Luego haga clic en el botón “Redes Wi-Fi” arriba a la izquierda para volver a la lista.
- Haga clic en el SSID, introduzca la contraseña “1234567890” y conéctese a la red.

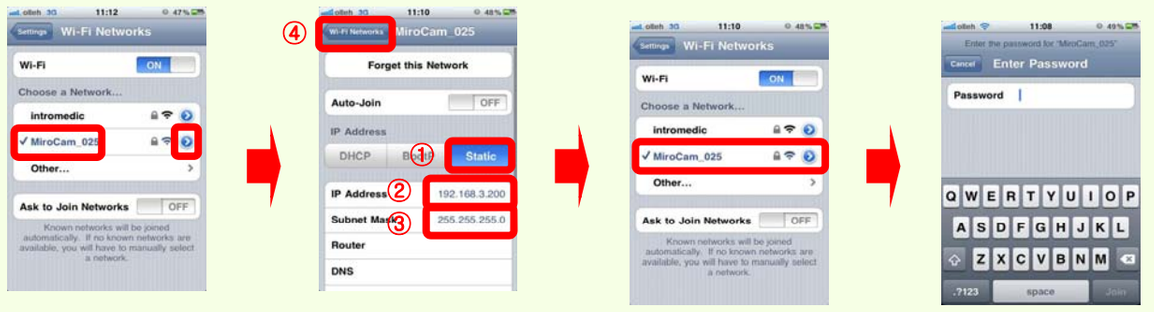

5 Abra la aplicación Wireless MiroView™ RTVi

- Haga clic en el icono para iniciar Wireless MiroView™ RTVi.
- Durante un momento aparecerá la pantalla de inicio y luego desaparecerá.
- Haga clic en el punto de acceso para mostrar las imágenes del paciente.

PRECAUCIÓN **Si pulsa el botón de cancelar (*cancel*) arriba a la izquierda de la pantalla, aparecerá una pantalla negra como la de la derecha. Haga clic en arriba a la derecha para volver a la pantalla anterior.**

- Introduzca la contraseña “1234567890” cuando el sistema se lo pida y haga clic en el botón de OK.

6 Después de usar Wireless MiroView™ RTVi

- Para cerrar Wireless MiroView™ RTVi, haga clic en el botón del iPhone para ir al menú y compruebe si el indicador LED del receptor se apagó.

PRECAUCIÓN **Si apaga primero el indicador Wi-Fi del receptor, aparecerá la ventana de la derecha al cabo de 10 segundos. Para cerrarla, haga clic en OK. .**

- Vaya a los Ajustes del teléfono.
- Active el Wi-Fi y desactívelo otra vez.

Copyright© 2011 IntroMedic Co., Ltd.
MM1300-1109 Version 1.0

Referencia **Para el uso detallado de MiroCam®, vea el Manual del Usuario MiroCam®.**